



Labcare
de Colombia



Certificado CO16/6735



MICROELISA

Los kits de inmunoensayo por microelisa de:



ReQuest®



Calbiotech



MP Biomedicals



IDS



Sensibilidad Alta



Mayor Economía



Gran Exactitud



Mejor Rendimiento

- Satisfacen las necesidades de productividad de una amplia gama de laboratorios.
- En el entorno altamente competitivo de hoy, ReQuest®, Calbiotech, MP Biomedicals e IDS aseguran un rendimiento confiable para pruebas diagnósticas de:
 - Autoinmunidad
 - Tamizaje neonatal
 - ToRCH
 - Enfermedades infecciosas
 - Marcadores de metabolismo óseo

La combinación de los kits de **ReQuest®**, **Calbiotech**, **MP Biomedicals** e **IDS** con la plataforma automatizada **ChemWell®** y/o con lector de microplaca **Stat Fax®**, hacen del Microelisa uno de los métodos más seguros, confiables y económicos para el diagnóstico y seguimiento de marcadores de Enfermedades infecciosas, Neonatales y de Autoinmunidad entre otras.

EQUIPOS MICROELISA


Labcare
de Colombia

Chemwell® 2910

Analizador automatizado para micro-elisa y química clínica



AW C2910

Stat Fax® 4200

Lector de Microplaca de 8 canales



AW CH4200

Stat Fax® 4700

Lector de Microtiras



AW CH4700

Stat fax® 2600

Lavador de Microtiras



AW ST2600

Stat fax® 2200

Incubador Agitador



AW ST2200

✓ Kits microelisa hormonas y marcadores tumorales



Ref.	Nombre producto
CB AC018T	ACTH ELISA
CB AD183E	ANDROSTENEDIONA ELISA
CB AF064T	AFP ELISA
CB CA125T	CA125 ELISA
CB CA153T	CA15-3 ELISA
CB CA199T	CA19-9 ELISA
CB CE236T	CEA ELISA
CB CO103S	CORTISOL ELISA
CB CP179S	PEPTIDO C ELISA
CB DH079S	DHEA-S ELISA
CB EF068F	ESTRIOL LIBRE ELISA
CB ES180S	ESTRADIOL ELISA
CB F3226T	T3 LIBRE ELISA
CB F4223T	T4 LIBRE ELISA
CB FS232F	FSH ELISA

Ref.	Nombre producto
CB FT178S	TESTOSTERONA LIBRE ELISA
CB HC047F	HCG ELISA
CB HG048H	GH ELISA
CB IS130D	INSULINA ELISA
CB LH231F	LH ELISA
CB PG129S	PROGESTERONA ELISA
CB PR234F	PROLACTINA ELISA
CB PS142C	PSA LIBRE ELISA
CB PS235T	PSA ELISA
CB PT019T	PTH ELISA
CB T3225T T3	ELISA
CB T4224T T4	ELISA
CB TE187S	TESTOSTERONA ELISA
CB TS227T	TSH ELISA

✓ Kits Marcadores Óseos



Ref.	Nombre producto
ID AC-57F1	REACTIVO PARA 25-HIDROXY VITAMINA D - ELISA
ID AC-02F1	REACTIVO PARA CROSSLAPS SERICOS (CTx-I) - ELISA

✓ Kits microelisa para pruebas de enfermedades infecciosas



Ref.	Nombre producto
CB DE050G	DENGUE VIRUS IGG ELISA
CB DE051M	DENGUE VIRUS IGM ELISA
CB H1029G	HSV-1 IGG ELISA
CB H1030M	HSV-1 IGM ELISA
CB H2031G	HSV-2 IGG ELISA
CB H2032M	HSV-2 IGM ELISA
CB HP013G	H. PYLORI IGG ELISA
CB HP014A	H. PYLORI IGA ELISA
CB HP015M	H. PYLORI IGM ELISA
CB MP020G	MYCOPLASMA IGG ELISA
CB MP021M	MYCOPLASMA IGM ELISA
CB ST084M	SALMONELA IGM ELISA
CB ST093G	SALMONELA IGG ELISA
CB TP076G	TREPONIMA PALLIDUM IGG ELISA
CB TP089M	TREPONIMA PALLIDUM IGM ELISA
CB TP094T	TREPONIMA PALLIDUM TOTAL ELISA
CB VZ081G	VARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV) IGG ELISA
CB VZ082M	VARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV) IGM ELISA

Ref.	Nombre producto
Q01-100	RUBEOLA IgG
Q01-110	RUBEOLA IgG
Q01-120	TOXOPLASMA IgG
Q01-140	CITOMEGALOVIRUS (CMV) IgG
Q01-150	CITOMEGALOVIRUS IgM
Q01-160	HSV 1&2 IgG
Q01-180	VARICELLA ZOSTER IgG
Q01-410	HSV IgG TIPO 1 ESPECIFICO
Q01-420	HSV IgG TIPO 2 ESPECIFICO
Q01-470	EPSTEIN BARR-VCA IgG
Q01-480	EPSTEIN BARR-VCA IgM
Q01-580	SIFILIS IgG



Labcare
de Colombia



www.labcarecolombia.com

✓ Kits para pruebas de autoinmunidad por microelisa




REQUEST	Ref.	Nombre producto	96 Pruebas
	Q01-210	REACTIVO PARA ANTI ds-DNA	
	Q01-230	REACTIVO PARA ANTI SM	
	Q01-240	REACTIVO PARA ANTI RNP	
	Q01-250	REACTIVO PARA ANTI-SSA	
	Q01-260	REACTIVO PARA ANTI-SSB	
	Q01-280H	REACTIVO PARA Jo 1	
	Q01-270H	REACTIVO PARA SCL 70	
	Q01-310H	REACTIVO PARA ANA SCREENING	

CALBIOTECH	Ref.	Nombre producto	96 Pruebas
	CB BM010T	BETA2 MICROGLOBULINA ELISA	
	CB CA034G	CARDIOLIPINA IGG ELISA	
	CB CA036M	CARDIOLIPINA IGM ELISA	
	CB MT073G	ANTICUERPO MITOCONDRIAL (AB MA) ELISA	
	CB TG070T	TIROGLOBULINA AB (TG) ELISA	
	CB TP069G	TPO IGG ELISA	

✓ Kits para pruebas de tamizaje neonatal por microelisa **MP**



MP BIOMEDICALS	Ref.	Nombre Producto	192 Pruebas
	MP 07-594303	TSH NEONATAL 2	
	MP 07-553300	GALACTOSA (SIN PLACA DE MEMBRANA)	
	MP 07-553303	GALACTOSA (CON PLACA DE MEMBRANA)	
	MP 07-571303	17A HIDROXIPROGESTERONA NEONATAL	
	MP 07-575300	FENILALANINA (SIN PLACA DE MEMBRANA)	
	MP 07-575303	FENILALANINA (CON PLACA DE MEMBRANA)	
	MP 07-596303	TRIPSINA NEONATAL	
	MP 07-590302	T4 NEONATAL 2	

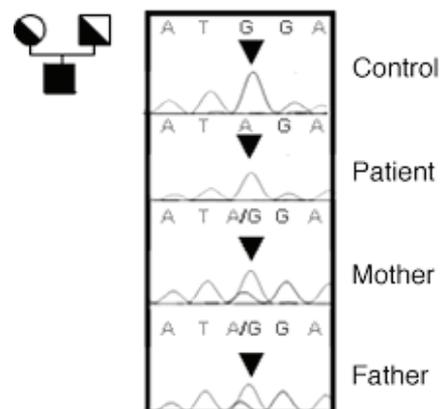

Labcare
de Colombia



www.labcarecolombia.com


✓ Evaluación externa de la calidad para pruebas de microelisa

Ref.	Nombre producto	Analitos	Presentación
ML 767	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO ANAS (ELISA/IFI)	3 EVENTOS ACP. EV1 EV2 EV3	1 PARÁMETRO
ML 772	SEROLOGÍA DE SIFILIS	3 EVENTOS	4 PARÁMETROS
ML 775	MARCADORES VIRALES HIV Y HEPATITIS	3 EVENTOS	7 PARÁMETROS
ML 782	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO ANAS EXPANDIDO (ELISA IFI, ANTICUERPOS: dsDNA, RNP, SSA, SSB, Sm)	3 EVENTOS	7 PARÁMETROS



RIQAS

Ref.	Nombre producto	Analitos	Presentación
RA RQ9125/A	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO INMUNOENSAYO (HORMONAS Y MARCADORES TUMORALES)	4 ANALITOS	KIT 12X5 ML
RA RQ9125/B	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO INMUNOENSAYO (HORMONAS Y MARCADORES TUMORALES)	13 ANALITOS	KIT 12X5 ML
RA RQ9125/C	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO INMUNOENSAYO (HORMONAS Y MARCADORES TUMORALES)	38 ANALITOS	KIT 12X5 ML
RA RQ9151	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO HIV, HTLV, CMV Y HEPATITIS	X 12 MESES	4 DESAFÍOS X 5 MUESTRAS C/U KIT
RA RQ9152	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO ToRCH	X 12 MESES	4 DESAFÍOS X 5 MUESTRAS C/U KIT
RA RQ9153	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO VIRUS EPSTEIN BARR	X 12 MESES	4 DESAFÍOS X 3 MUESTRAS C/U KIT
RA RQ9154	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO SEROLOGIA DE SIFILIS	X 12 MESES	4 DESAFÍOS X 3 MUESTRAS C/U KIT

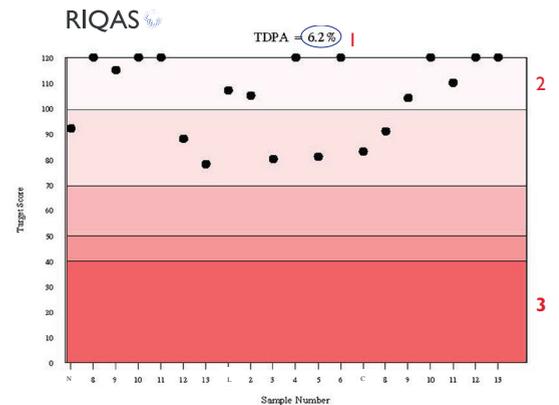


1. Este es el límite superior de desviación para este parámetro. Los TDPAs son revisados con regularidad por el grupo de especialistas de RIQAS
2. Una puntuación >50 en el área con sombreado claro representa un buen rendimiento
3. Un sombreado intenso para valores de 10 a 50 indica un mal rendimiento





Control de calidad interno independiente para pruebas de microelisa (hormonas, marcadores tumorales e infecciosas)

	Ref.	Nombre producto	Presentación
RANDOX	RA IA3112	CONTROL INMUNOENSAYO (HORMONAS, MARCADORES TUMORALES E INFECCIOSAS) PLUS TRINIVEL	12X5 ml
	RA IAS3113	CONTROL INMUNOENSAYO ESPECIALIDAD I (VIT D, PTH, PEPTIDO C) NIVEL 1	5X2 ml
	RA IAS3113	CONTROL INMUNOENSAYO ESPECIALIDAD I (VIT D, PTH, PEPTIDO C) NIVEL 2	5X2 ml
	RA IAS3113	CONTROL INMUNOENSAYO ESPECIALIDAD I (VIT D, PTH, PEPTIDO C) NIVEL 3	5X2 ml
PRUEBAS INFECCIOSAS SERACARE	SC A001-4408-P	CONTROL POSITIVO ACCURUN 1 S4400 PARA HIV 1Y2, HCV, HBC, HTLV I y II, CMV y HBsAg PARA BEST 2000	12 x 3.5 ml
	SC A135-5004	CONTROL POSITIVO ACCURUN PARA TOXOPLASMA IgG	1 x 1.0 ml
	SC A136-5004	CONTROL POSITIVO ACCURUN PARA TOXOPLASMA IgM	1 x 1.0 ml
	SC A140-5001	CONTROL POSITIVO ACCURUN PARA RUBEOLA IgG	1 x 5.0 ml
	SC A141-5004	CONTROL POSITIVO ACCURUN PARA RUBEOLA IgM	1 x 1.0 ml
	SC A145-5004	CONTROL POSITIVO ACCURUN PARA CITOMEGALOVIRUS (CMV) IgG	1 x 1.0 ml
	SC A146-5004	CONTROL POSITIVO ACCURUN PARA CITOMEGALOVIRUS (CMV) IgM	1 x 1.0 ml
	SC A150-5004	CONTROL POSITIVO ACCURUN PARA HERPES VIRUS (HSV) IgG	1 x 1.0 ml
	SC A155-2010	CONTROL POSITIVO ACCURUN S2000 PARA SIFILIS (ATA)	3 x 2.0 ml
	SC A25-5006	CONTROL POSITIVO ACCURUN 25 PARA EL ToRCH IgG	3 x 1.0 ml
SC A26-5006	CONTROL POSITIVO ACCURUN 26 PARA EL ToRc IgM	3 x 1.0 ml	

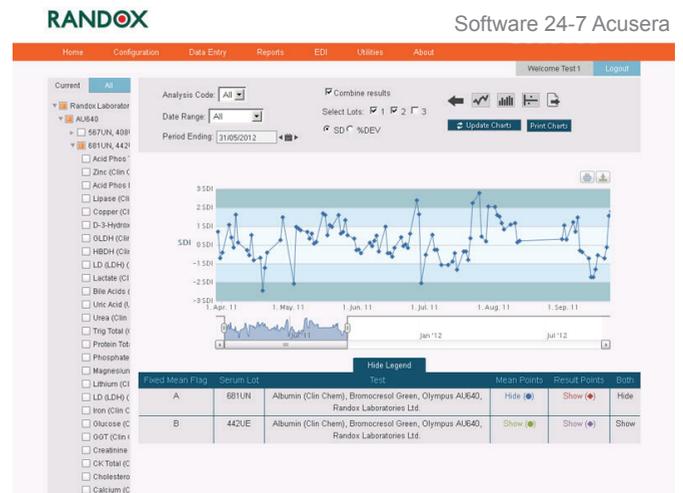

Software Seracare E-Quality

