CATÁLOGO

Labcare de Colombia

SGS (CO16/6735)

Kaßla®

Soluciones para un Diagnóstico Oportuno

Pruebas Multiparamétricas en Orina (Panel)

Panel de Drogas Instant-View™

Registro Sanitario No. 0025R2017 SSA

El Panel de Drogas en Orina Instant-View™ es un inmunoensayo cualitativo para detectar la presencia de 2 hasta 12 diferentes drogas y/o sus metabolitos en orina humana de acuerdo a puntos de corte específicos, en un solo ensayo. Existen diferentes presentaciones que varían de acuerdo con la cantidad y tipos de parámetros (drogas) capaces de detectar. A cada droga le corresponde un resultado independiente, el cual es identificado por medio de abreviaturas y colores diferentes para una fácil interpretación de resultados, en solo 5 minutos.

Catálogo	Formato	Parámetros	Contenido
500444	Panel	2 COC/THC	x25
726164		3 AMP500/COC150/THC	
538794		3 AMP/COC/THC	
537333		3 COC/MET/THC	
570935		4 AMP/BZO/COC/THC	
570205		4 AMP/COC/MET/THC	
569109		4 AMP/COC/MOR/THC	
555230		4 AMP/COC/XTC/THC	
568744		4 COC/MET/BZD/THC	
591754		5 AMP/BAR/BZO/COC/THC	
597963		5 AMP/BAR/COC/MET/THC	
595041		5 AMP/BZD/COC/MET/THC	
596502		5 AMP/BZD/COC/MOR/THC	
612573		5 AMP/COC/MET/MOR/THC	
610381		5 BZD/COC/MET/MOR/THC	
612938		5 COC/MET/MOR/PCP/THC	
646176		6 AMP/BAR/BZD/COC/MOR300/THC	
639236		6 AMP/COC/MET1000/MOR2000/THC/XTC	
644715		6 AMP/BAR/BZD/COC/MET/THC	
633757		6 AMP/BZD/COC/MET/MOR/THC	
649828		6 AMP/COC/MET/MOR/PCP/THC	
680143		7 AMP/BAR/BZD/COC/MET/MOR/THC	
714110		8 AMP/BAR/BZD/COC/MET/MOR/THC/PCP	
737851		10 AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ MOR300/ MTD/ PCP/ THC/ XTC	
733833		10 AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ MOR/ MTD/ PCP/ THC/ TCA	
753556		12 AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET1000/ MOR2000/ MTD/ PCP/ PPX/ TCA/ THC/ XTC)	

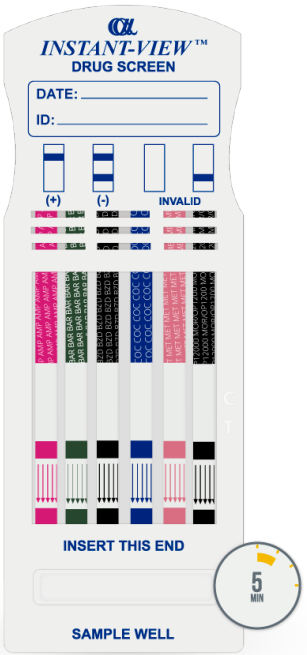

El Panel Instant-View ™ permite 2 métodos de aplicación:



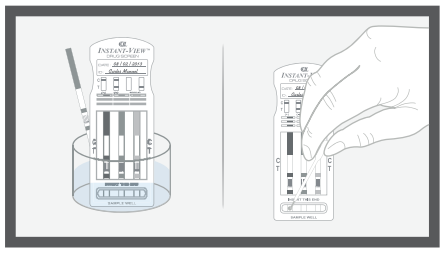



1) Inmersión, en el que el dispositivo es sumergido en la muestra de orina de manera que la membrana absorbente tenga contacto con el espécimen, lo cual da inicio al proceso de flujo lateral.

2) Por gotero, cada prueba incluye un gotero plástico desechable a través del cual se puede recolectar la muestra y depositar sobre la membrana absorbente del dispositivo, estando este en una superficie plana.

Panel de Drogas

CERTUM

Registro Sanitario No. 0481R2018 SSA

El Panel Multidrogas Certum le permite realizar exámenes para detectar 2, 3, 5 y hasta 6 drogas al instante, en diferentes combinaciones. Para realizar la prueba, sólo es necesario insertar un extremo del dispositivo en la muestra de orina durante 10 - 15 segundos y después de 5 minutos leer los resultados para cada tipo de droga.

Catálogo	Formato	Parámetros	Contenido
DOA-124	Panel	2 THC/ COC	x25
DOA-124-1		2 MQL300/ LSD20	
DOA-134		3 THC/ COC/ AMP	
DOA-134-2		3 THC/ COC/ MET	
HDOA-334		3 THC/ COC/ AMP	
DOA-144		4 THC/ COC/ AMP/ MET	
DOA-154		5 THC/ COC/ AMP/ MET/ OPI	
DOA-154-4		5 THC/ COC/ AMP/ MET/ BZD	
DOA-154-2		5 THC/ COC/ AMP/ BAR/ BZD	
HDOA-254		5 THC/ COC/ AMP/ MET/ OPI	
DOA-164		6 THC/ COC/ AMP/ MET/ OPI/ BZD	
DOA-164-2		6 THC/ COC/ AMP/ MET/ BAR/ BZD	
HDOA-264		6 THC/ COC/ OPI/ AMP/ BZO/ MET	
DOA-174		7 THC/ COC/ AMP/ MDMA/ LSD/ K2/ MET	
DOA-174-2		7 AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ MOR/ THC	
DOA-184		8 THC/ COC/ AMP/ MDMA/ LSD/ K2/ MET/ OPI	
DOA-184-3		8 AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ MOR/ THC/ XTC	
DOA-184-2		8 AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET/ MOR/ THC/ PCP	
DOA-194		9 AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET/ MOR/ MTD/ PCP/ THC	
DOA-1104		10 AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET/ MOR/ MTD/ PCP/ THC/ TCA	
DOA-1114		11 AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET1000/ MOR2000/ MTD/ PCP/ TCA/ THC/ XTC	
DOA-1124		12 AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET1000/ MOR2000/ MTD/ PCP/ PPX/ TCA/ THC/ XTC	

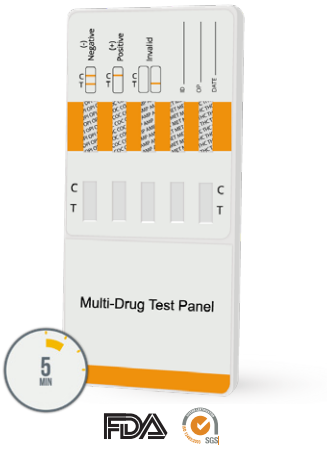

Panel de Drogas

Artron Laboratories Inc.

Registro Sanitario No. 2618R2017 SSA

Es una prueba cualitativa destinada proporcionar una detección rápida de drogas de abuso en orina.

Catálogo	Formato	Parámetros	Contenido
A04-14-140	Panel	Panel Multidrogas 2 (COC/THC)	x25
A04-15-140-A		Panel Multidrogas 3 (COC/AMP/THC)	x20
A04-17-140-A		Panel Multidrogas 5 (COC/AMP/THC/MET/OPI)	
A04-17- 140-C		Panel Multidrogas 5 (COC/AMP/THC/MET/BZO)	
A04-17-140-B		Panel Multidrogas 5 (COC/AMP/THC/BAR/BZO)	
A04-19-140-A		Panel Multidrogas 6 (COC/AMP/THC/MET/OPI/BZO)	
A04-21-140-A		Panel Multidrogas 7 (COC/AMP/THC/MET/OPI/BAR/BZD)	

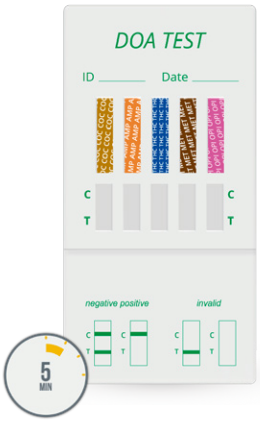

Pruebas Individuales en Orina

Cassette Individual de Drogas

CERTUM

Registro Sanitario No. 0267R2017 SSA

Es una prueba de drogas en cassette Certum brindan método asequible y confiable para detección individual de consumo de drogas en orina.

Catálogo	Formato	Parámetros	Contenido
DAM-102	Cassette	Anfetamina AMP	x40
DBA-102		Barbitúricos BAR	
DBZ-102		Benzodiacepina BZD	
DCO-102		Cocaína COC	
DET-102		Etilglucurónido ETG	
DFY-102		Fentanilo FYL	
DMD-102		Éxtasis XTC	
DME-102		Metanfetamina MET	
DMP-102		Metilfenidato MPD	
DOP-102		Opiáceos OPI	
DPC-102		Fenciclidina PCP	
DTH-102		Marihuana THC	

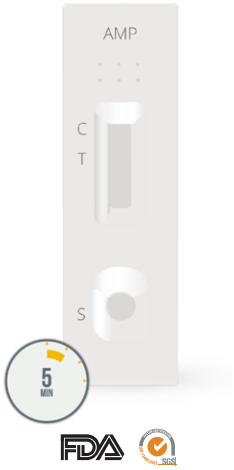

Cassette Individual de Drogas

Instant-View™

Registro Sanitario No. 1530R2018 SSA

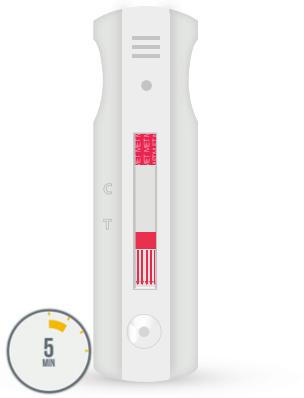

La prueba en cassette de detección de drogas en orina Instant-View™ es un inmunoensayo cualitativo para detectar la presencia de metabolitos de las drogas en orina humana, de acuerdo con puntos de corte específicos. Kabla ofrece la selección de drogas detectables más amplia en México.

Catálogo	Formato	Parámetros	Contenido
406211	Cassette	Anfetamina AMP	x25
391602		Antidepresivos Tricíclicos TCA	
457345		Barbitúricos BAR	
450040		Benzodiazepina BZD	
420821		Cocaína COC	
384297		Éxtasis MDMA - XTC	
442735		Fenciclidina PCP	
1059995		Ketamina KET	
428126		Marihuana THC	
464650		Metadona MTD	
413516		Metanfetamina MET	
435431		Morfina -Opiáceos MOR / OPI	
351425		Oxicodona OXY	
376992		Propoxifeno PPX	
18688		Tramadol TRA	

Tira Individual de Drogas

CERTUM

Registro Sanitario No. 0344R2018 SSA

La prueba en tira individual para la detección de drogas en orina Certum es un inmunoensayo cualitativo para detectar la presencia de drogas y/o sus metabolitos en orina humana de acuerdo a puntos de corte específicos, en un solo ensayo.

Catálogo	Formato	Parámetros	Contenido
DAM-101	Tira	Anfetamina AMP	x50
DBA-101		Barbitúricos BAR	
DBZ-101		Benzodiacepina BZD	
DCO-101		Cocaína COC	
DPC-101		Fenciclidina PCP	
DTH-101		Marihuana THC	
DME-101		Metanfetamina MET	
DMP-101		Metilfenidato MDP	
DOP-101		Opiáceos OPI	

Tira Individual de Drogas

Instant-View™

Registro Sanitario No. 3159R2013 SSA

La línea de pruebas de detección de drogas en tira Instant-View™, es frecuentemente utilizada por laboratorios y hospitales. Este producto mantiene una ventaja sumamente competitiva ya que destaca por ser método más económico para realizar una prueba de detección de drogas, además de ser preciso y mantener la confiabilidad de Instant- View ™.

Catálogo	Formato	Parámetros	Contenido
03-3017	Tira	Anfetamina AMP	x50
03-3157		Barbitúricos BAR	
03-3137		Benzodiazepina BZD	
03-3057		Cocaína COC	
03-2957		Éxtasis MDMA - XTC	
03-3117		Fenciclidina PCP	
03-3077		Marihuana THC	
03-3037		Metanfetamina MET	
03-3097		Morfina Opiáceos MOR / OPI	

Pruebas de Drogas en Frasco Integrado

Split Screen Cup

CERTUM

Registro Sanitario No. 0277R2018 SSA

El frasco de detección múltiple Certum Split Screen Cup es el sistema más avanzado para determinar el consumo de drogas en la orina. Debido a que cuenta con un sistema de seguridad único, termómetro y panel de resultados montado de manera independiente, éste frasco se encuentra notablemente por encima de cualquier opción en el mercado.

Catálogo	Parámetros	Contenido
HCDOAA-334	3 AMP/COC/THC	x25
HCDOAA-234	3 COC/MET/THC	
HCDOAA-1254	5 AMP/BAR/BZD/COC/THC	
HCDOAA-254	5 AMP/COC/MET/OPI/THC	
HCDOAA-1454	5 AMP/COC/MET/PCP/THC	
HCDOAA-154	5 AMP/COC/OPI/PCP/THC	
HCDOAA-1164	6 AMP/BAR/BZD/COC/MET/THC	
HCDOAA-264	6 AMP/BZD/COC/MET/OPI/THC	
HCDOAA-1364	6 AMP/BZD/COC/MET/PCP/THC	
HCDOAA-164	6 AMP/COC/MET/OPI/PCP/THC	
HCDOAA-974N	7 AMP/BAR/BZD/COC/MET/OPI/THC	
HCDOAA-474S	7 AMP/COC/MDMA/MET/OPI/PCP/THC	
HCDOAA-984S	8 AMP/BAR/BZD/COC/MET/OPI/PCP/THC	
HCDOAA-3104	10 AMP/BAR/BZD/COC/MDMA/MET/MTD/OPI/PCP/THC	
HCDOAA-18104	10 AMP/BAR/BZD/COC/MDMA/MET/OPI/PCP/TCA/THC	

Simple Cup

CERTUM

Registro Sanitario No. 0277R2018 SSA

El Frasco de Detección de Drogas Certum Simple Cup ofrece un método de prueba de drogas que permite la detección de 3 y hasta 14 diferentes drogas de abuso y terapéuticas en menos de cinco minutos, sin tener que llevar a cabo ningún paso. Solo es necesario solicitar al sujeto una muestra de orina, retirar su etiqueta de seguridad y leer los resultados inmediatamente.

Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Contenido
HCDOAB-334.3	3 AMP/COC/THC	Orina	Frasco	x25
HCDOAB-1154	5 AMP/BZD/COC/MET/THC			
HCDOAB-255.5	5 AMP/COC/MET/MOR/THC			
HCDOAB-1164.6	6 AMP/BAR/BZD/COC/MET/THC			
HCDOAB-264	6 AMP/OPI/BZD/COC/MET/THC			

Frasco

Instant-View™ CUP

Registro Sanitario No. 0511R2018 SSA

El frasco Instant Cup múltiple ofrece un método rápido, sencillo y económico para realizar sus pruebas de detección de drogas. Solo es necesario solicitar al sujeto una muestra de orina, retirar su etiqueta de seguridad y leer los resultados inmediatamente.

Catálogo	Drogas glutaraldehido	Parámetros	Contenido
03-4638 (Ind)	5	(AMP/COC/MET/MOR/THC)	x25
03-4609	3	(AMP/COC/THC)	
03-4638	5	(AMP/COC/MET/MOR/THC)	
03-4642	6	(AMP/BAR/BZD/COC/MET/THC)	
03-4666	6	(AMP/BZD/COC/MET/MOR/THC)	
03-4666TSP	6	(AMP/BZD/COC/MET/MOR/THC)	
03-4668T SP	10	(AMP/COC/MET/MOR/PCP/THC) con Adulterantes (CR/NI/GL/pH/SG/OX)	

Prueba de Cotinina

SERATEC® Gesellschaft für Biotechnologie mbH

Registro Sanitario No.426R2018 SSA

La prueba SERATEC® Drug Screen COT es un inmunoensayo de flujo lateral en un paso para la detección cualitativa de Cotinina en orina humana con concentración de punto de corte de 200 ng/ml. Se pretende que este producto sea para uso profesional, se obtiene un resultado visual y cualitativo.

Catálogo	Parámetro	Formato	Contenido
COT/40	Cotinina	Cassette	x40 / x12

Pruebas de Drogas en Fluido Oral

Prueba de Drogas Saliva Screen

Saliva Screen Test

ultimed

Registro Sanitario No. 1299R2017 SSA

La prueba para detectar múltiples drogas en saliva es una alternativa práctica y conveniente para muchas situaciones en las que las posibilidades de tomar una muestra de orina se ven limitadas. La prueba de drogas en saliva ofrece además la mayor seguridad de la integridad de la muestra, al ser el espécimen recolectado en presencia del sujeto.

Catálogo	Parámetro	Formato	Contenido
008S603	THC-COC-AMP-MET-BAR-BZD	Cassette	x25

Accesorios para Recolección y Validación de Muestras

Prueba de Adulterantes en orina

UrineCheck7

Registro Sanitario No. 2194R2018 SSA

La tira de detección de Adulterantes en Orina UrineCheck 7 tiene el objetivo de evaluar la integridad de los especímenes de orina antes de realizar las pruebas de drogas de abuso, la tirilla de prueba de adulteración de orina UrineCheck 7, ayuda a la determinación cualitativa visual de creatinina, nitrito, glutaraldehido, ph, gravedad específica, almidón y clorocromato de piridinio en la orina.

Catálogo	Parámetros	Contenido
D700-25G	OX, SG, PH, NI, GL, CR, PCC	x25 sobres laminados

*Para una estabilidad Kabla solo ofrece la prueba en sobre laminado.

Guía de Abreviaturas de Drogas de Abuso
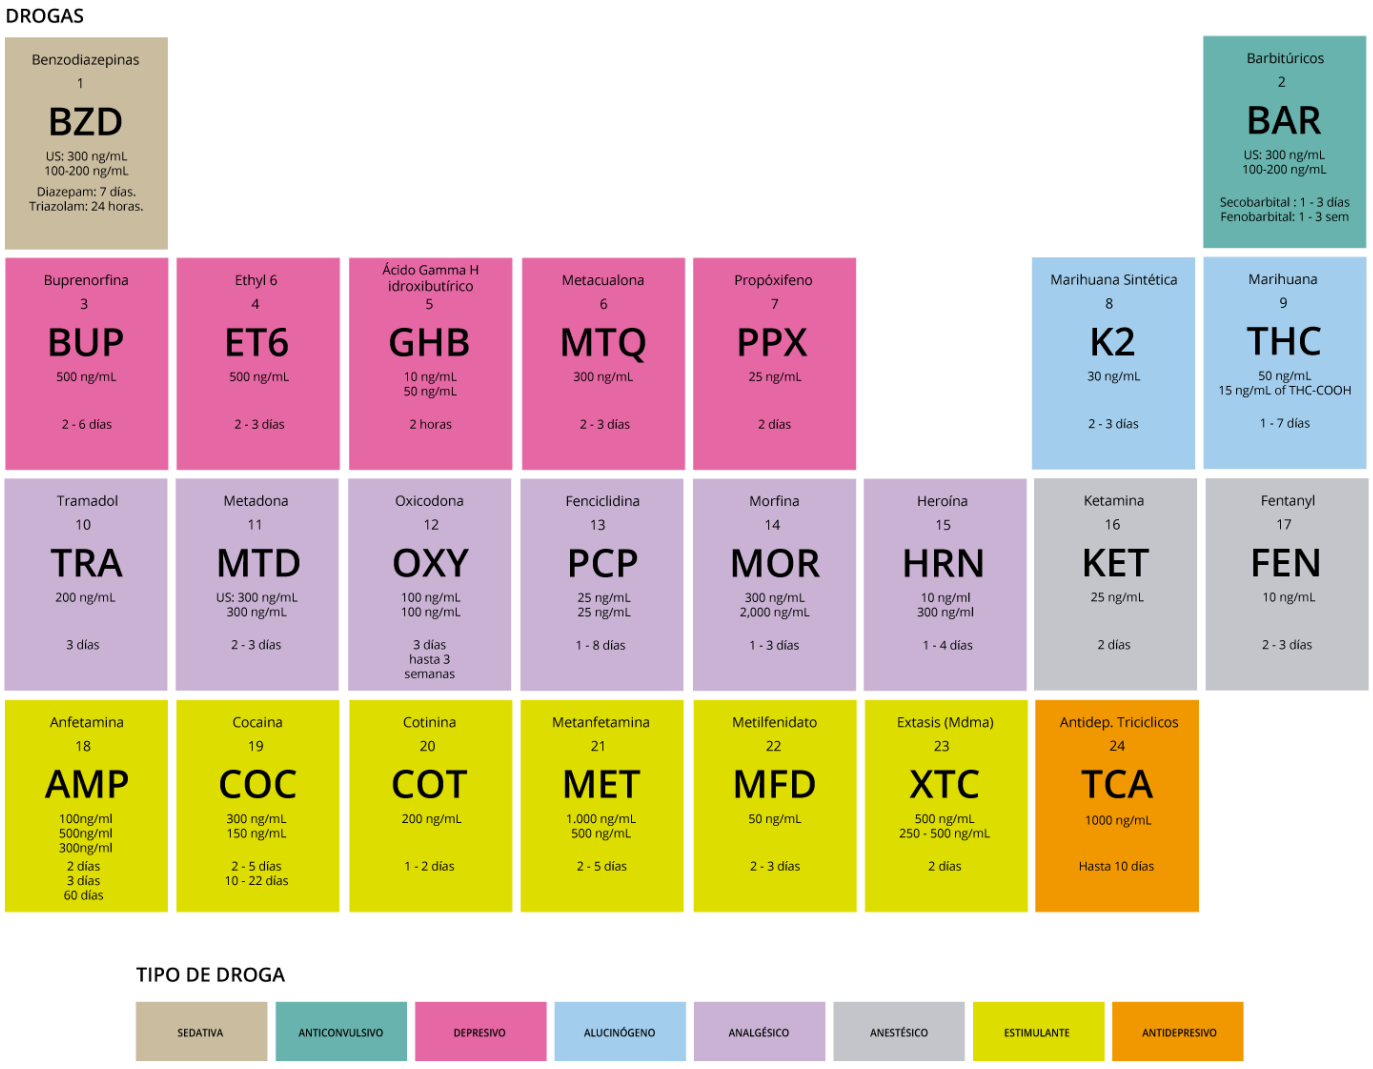
Nuestra experiencia nos permite conocer a fondo las necesidades de empresas, laboratorios y centros de control para garantizar una adecuada toma y manejo de muestra.